

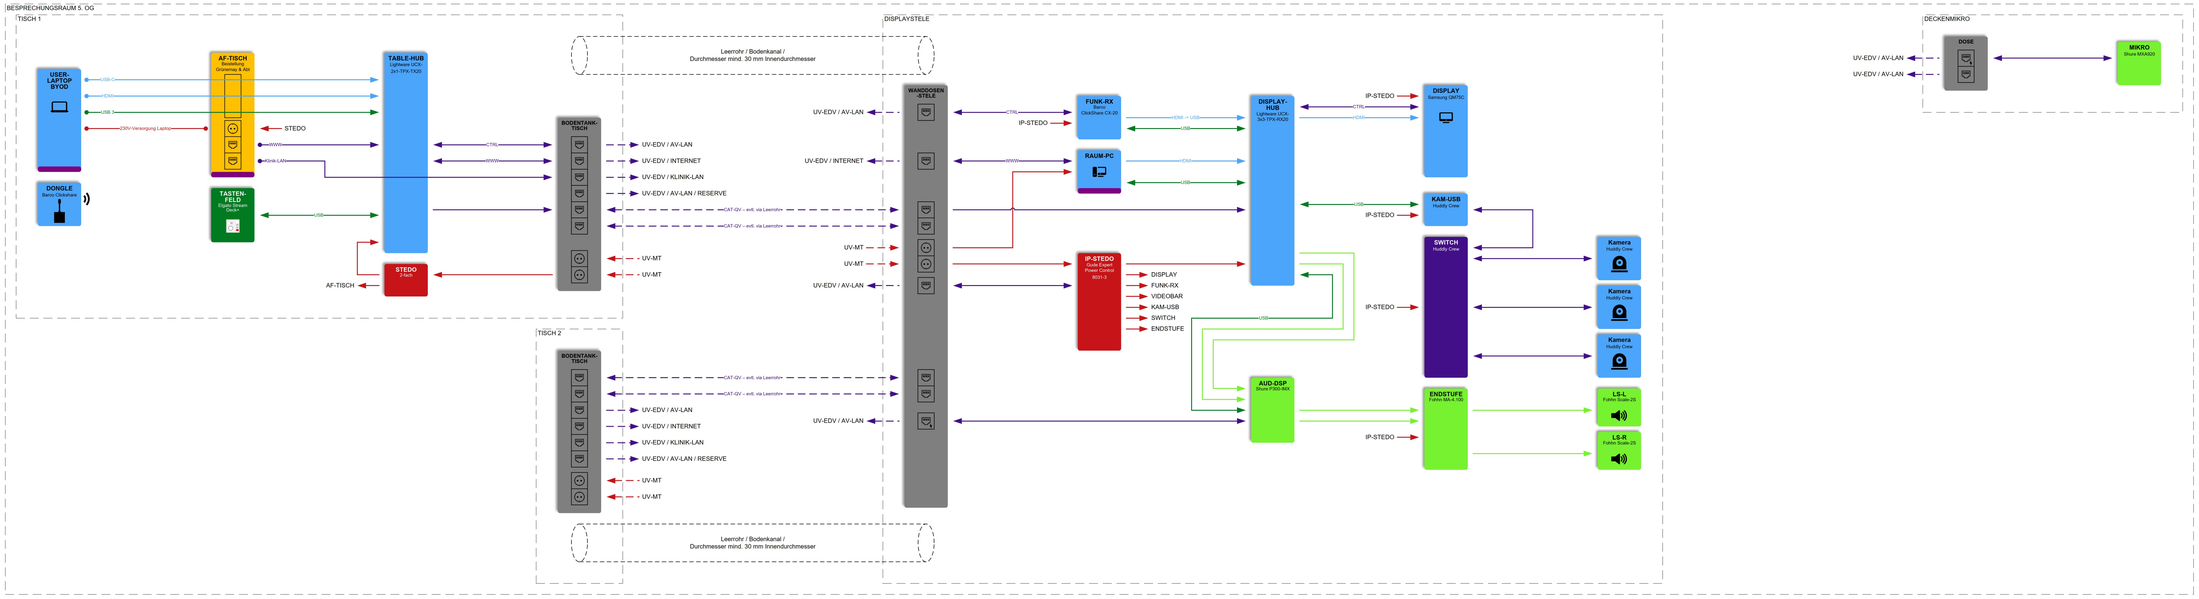


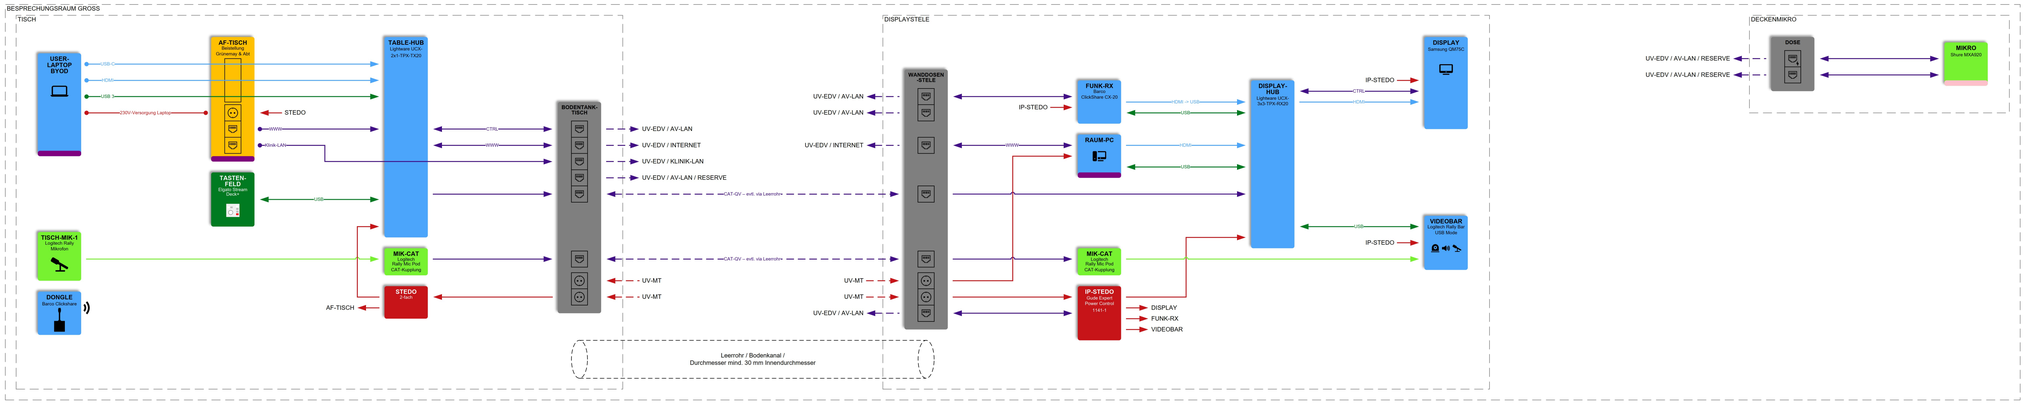

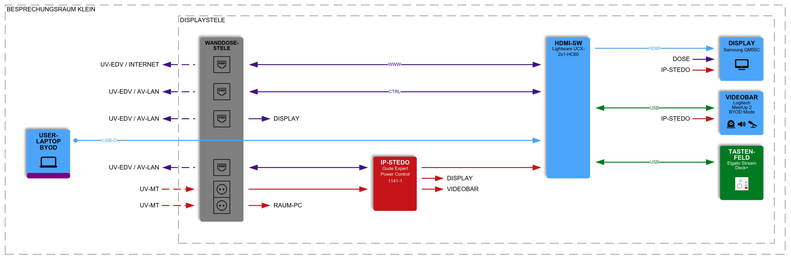

Gerät
optional
Bestellung
AUDIO
VIDEO
230 V
IT
STEUERUNG
Patch-leitung
Verlege-leitung
LAN
AUDIO
VIDEO
230V
ANTENNE
OPTISER
HDbT
USB
SDI
Kabeldurchführung
RJ45-Buchse
PoE-Buchse
Schuko-Buchse
Klinken-Buchse
Cinch-Buchse
HDMI-Buchse
VGA-Buchse
DVI-Buchse
Speakon Buchse
USB-Buchse
XLR-Buchse

Universitätsklinikum Tübingen
Ersatzneubau Pathologie und Humangenetik

Prinzipschaltbild
BESPRECHUNGSRÄUME

Projektnummer	20_040	
Gewerk	Medientechnik	
Leistungsphase	Ausführungsplanung	
Gezeichnet		201201
Geprüft		260423
Druck	260423	
Format	DIN A0	SEITE 1/1

DATEI: PHM_PSB_BESPRECHUNGSRAEUME_260423.vsdx

Weitergabe dieser Zeichnung an Dritte nur mit unserer Genehmigung. – Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadensersatz.